


作業用救命衣 WP-2

小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの／膨脹式
国土交通省型式承認番号 第5337号

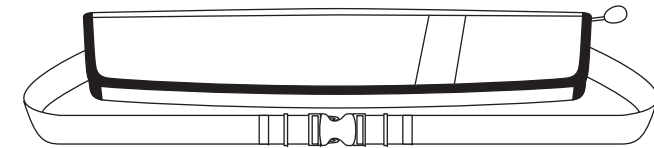

取扱説明書

「作業用救命衣 WP-2」をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をご通読ください。

また、いつでも再読できるよう、大切に保管してください。

WP-2/27 (2015) 08-18

Fujikura

 藤倉航装 株式会社

〒142-0063 東京都品川区荏原2丁目4番46号
TEL.03-3785-2108(お問い合わせ窓口 営業部)
FAX.03-3784-0416

無断複製、無断転載を禁止します。AUG.2015

はじめに

WP-2/27 (2015) 08-18

- 「作業用救命衣 WP-2」（以下「救命衣」と略します）をご使用になる前に、この取扱説明書を必ずご通読ください。
- 取扱説明書の各項に記載されている諸注意事項を厳守してください。
- 取扱説明書はいつでも再読できるよう、分かりやすい場所に、大切に保管してください。
- 救命用途以外の使用、救命衣の改造、取扱説明書の内容を無視した取り扱いは、絶対にしないでください。
- 取り扱い方法が不明のときは、必ずこの取扱説明書を再読し、正しい取り扱い方法に従って使用してください。再読してもよくわからないときは、お買い求めの販売店または弊社までお問い合わせ、ご確認のうえご使用ください。

無断複製、無断転載を禁止します。AUG.2015

目次

はじめに	巻頭
1 安全のために	1
1. 取扱説明書に記載されている注意事項について	1
2. 救命衣を安全にお使いいただくための注意事項	2
3. 「型式」と「取り扱い注意」標示布の取り付け位置	6
2 概要	8
1. 概要	8
2. 主な仕様	8
3. 主要部の名称と機能	9
4. ガス充填装置の構造	10
3 使用前の自主点検	11
1. ガス充填装置の点検	11
2. 救命衣の点検	13
■救命衣の点検項目	14
4 着用	15
■着用の手順	16
5 作動方法と膨脹後の送気操作	18
1. 手動作動と自動作動	18
2. 手動による作動	19
3. 補助送気装置（作動後の送気、排気操作）	20
6 膨脹使用後の部品交換	21
1. 交換の手順	22
2. 作動環境と作動方法の違いによるガス充填装置各部の状態	24
7 着用後、膨脹使用後の整備	25
1. 着用後の整備	25
2. 膨脹使用後の整備	26
3. 気室の取り付け、取り外し	26
8 救命衣の折り畳み方法	27
9 保管とメンテナンス	31
1. 救命衣の保管	31
2. 使用期限について	31
3. 定期点検	32

1 安全のために

1. 取扱説明書に記載されている注意事項について

この取扱説明書では諸注意事項を、救命衣の使用に当たって予測される事故や不具合の内容、程度によって、下記の5種類に分けて表記しています。



記載された注意事項を守らないと、重大事故が発生する確率が（人身に過酷な損害や死をもたらす危険発生確率が）極めて高いもの。



記載された注意事項を守らないと、重大事故が発生する（人身に過酷な損害や死をもたらす危険の発生する）可能性があるもの。



記載された注意事項を守らないと、人身に中程度または軽度の障害をもたらすおそれのあるもの。あるいは、物的損害（家屋、家財など）に結びつくもの。



記載された注意事項を守らないと、救命衣を損傷したり、救命衣の耐久性を著しく短くするおそれのあるもの。あるいは法令違反になるもの。



救命衣を使用するうえで、知っておいていただきたいこと。

2. 救命衣を安全にお使いいただくための注意事項



1. ガス充填装置を作動させたときは、速やかに、装置の炭酸ガスボンベと、着水したときはカートリッジも新品のものと交換してください。

ガス充填装置の炭酸ガスボンベとカートリッジは、一度作動させると再使用できません。ガス充填装置を作動させたときは、速やかに最寄りの販売店を通じて新品の炭酸ガスボンベと、着水したときはカートリッジも購入して、交換してください。

（21ページ「膨脹使用後の部品交換」の項を参照してください）

2. この救命衣は、意識のある人を対象としています。着水、膨脹後、自力での調整が必要になります。

この救命衣は、着水、膨脹後、安定した仰向けの浮遊姿勢を得るために、自力での姿勢の立て直しや、修正が必要になります。

3. ご購入後、お客様による改造、修理は絶対にしないでください。

アイロンプリント、刺しゅう、ワッペンなどの縫い付けなどを行うと、気室を傷つけ、最悪の場合、救命衣が膨脹しなかったり、空気漏れを起こしたりするおそれがあります。たいへん危険ですので、絶対に行わないでください。



1. 救命衣を使用するときは、その都度11ページ「使用前の自主点検」の項に従って、ガス充填装置と救命衣の点検を行ってください。（11ページ「使用前の自主点検」の項を参照してください）

2. 救命衣を使用する前に、補助送気装置から空気を気室に注入しないでください。

救命衣を使用する前に、補助送気装置から空気の注入を行うと、ガス充填装置が作動したとき救命衣の気室内の圧力が過大になり、最悪の場合、気室が破裂する事があります。

3. 救命衣を着用する前に、ブローチ、ボールペン、ネクタイピン、安全ピンなど、気室を傷つけるおそれのある突起物や鋭利なものは、身体から取り外してください。

気室を傷つけると、最悪の場合、救命衣が膨脹しなかったり、空気漏れを起こしたりするおそれがあります。安全のため厳守してください。

4. 救命衣を取り扱うときは、火気に注意してください。

救命衣の気室は、ポリウレタン加工を施した引き布で作られています。火気を近づけると穴があき、使用できなくなります。ストーブやタバコの火などには十分注意してください。

前ページより続く



5. 救命衣は必ず衣服の上から着用してください。

救命衣を作業服や雨衣の下に着用すると、手動用動作索の握り手を探すのに手間取ったり、水の浸入が妨げられてガス充填装置が作動しなかったりするおそれがあります。

また、救命衣の上に服を着用すると、気室の膨脹が妨げられ、正常に膨脹しないおそれがあります。

6. この救命衣は、身長 140cm 以上、腰回り寸法 130cm 以下の、手動によりガス充填装置を作動させることができる大人用です。

上記の条件を満たしていない人は、使用しないでください。

7. 車内の保管などにより救命衣が熱くなっているときは、常温になってから着用してください。

熱くなっている状態で着用するとやけどするおそれがあるほか、ガス充填装置が作動したとき救命衣の気室内の圧力が過大になり、最悪の場合、気室が破裂する事があります。

8. 着用する前に、ガス充填装置に新品の炭酸ガスポンベが取り付けられていて、シールピンが折損していないか、またカートリッジ開口部のボンベインジケーターが使用可の標示色（緑色）になっているか確認してください。

シールピンが折損しているとき、カートリッジ開口部のボンベインジケーターが赤色標示になっているとき、カートリッジ中間部にあるスプリング部の隙間から赤色のカートリッジインジケーターが見える状態のときは、使用できません。（11ページ「使用前の自主点検」の「ガス充填装置の点検」の項を参照してください）

9. 着用する前に、救命衣が膨らんでいないか確認してください。

もし、救命衣が膨らんでいるようでしたら、炭酸ガスポンベ内のガスが漏れているおそれがあります。そのまま使用すると、救命衣が膨脹しないおそれがありますので、ガス充填装置から炭酸ガスポンベを取り外して、ポンベの封板に穴があいていないか点検してください。

（11ページ「使用前の自主点検」の「ガス充填装置の点検」の項を参照してください。）

10. 着用する前に、ガス充填装置本体にひび割れなどの破損が無いか確認してください。

ひび割れなどを発見したときは、救命衣を使用しないでください。正常に作動しないおそれがあります。

11. 着用する前に、バックルが壊れていないか、腰ベルトに損傷がないか確認してください。

バックルが壊れていたり、腰ベルトに損傷があると、水中に飛び込んだとき、救命衣が身体から外れるおそれがあります。

12. 着用後は、手動用動作索の握り手が保護カバーの外に出ていて、手で引ける状態になっているか確認してください。



●着水時の注意事項について

1. 時間的に余裕があるときは、救命衣を膨脹させた状態で水中に飛び込んでください。

この救命衣は、手動による作動が基本です。船が沈み始めて脱出するときなどで、救命衣を手動で膨脹させる時間的余裕があるときは、水中に飛び込む前に救命衣を手動で膨脹させてください。

また、水中に飛び込むときは、膨脹した救命衣を両手でしっかり抱きかかえてください。

2. 飛び込む高さは3m以下としてください。

3. この救命衣は、水を感じて膨脹する自動作動機能も備えていますが、この機能はあくまでも補助的な機能です。着水後は、自動作動機能に頼らないで、握り手（手動用動作索）を引いて手動で膨脹させてください。

（18ページ「作動方法と膨脹後の送気操作」の項を参照してください）

4. 水中で浮遊しているとき、救命衣を損傷するおそれのある浮遊物には近づかないでください。

気室を傷つけると、最悪の場合、空気漏れを起こして浮力を失うおそれがあります。



●着用上、取り扱い上の注意事項について

1. この救命衣は、救命用です。救命以外の用途には使用しないでください。

2. 着用時、頻繁に壁やロープ、その他の物と、こすれ合うような状態での使用はしないでください。

保護カバーの損傷はもちろんのこと気室を損傷し、万一の場合、気室からの空気漏れを起こす危険性があります。

3. ガス充填装置の取り付け用袋ナットを取り外して、気室からガス充填装置を取り外さないでください。また、袋ナットの増締めはしないでください。ガス充填装置を損傷するおそれがあります。

4. カートリッジは、交換時以外取り外さないでください。

5. 救命衣は落としたり、投げたりしないでください。

注意の項は、次ページに続きます。



●洗濯について

1. 気室は洗濯できません。

気室に塩分や汚れがついたときは、水を含ませたガーゼなどで軽くたたくようにして拭き取ってから、ハンガーに掛けて陰干ししてください。
気室のみ洗いや、洗濯機での洗濯はしないでください。気室がひび割れし、損傷するおそれがあります。
(26ページ「気室の取り付け、取り外し」の項を参照してください)

2. 保護カバーを洗濯するときは、必ず気室から取り外して保護カバーだけを洗濯してください。

洗濯機を使用して保護カバーを洗濯するときは、保護カバーの面ファスナーを閉じて、ネット袋に入れてください。濃色のものは色落ちすることがありますので、ほかの物とは一緒に洗わないでください。洗剤は、漂白剤が入っていない洗剤を使用してください。ドライクリーニングはしないでください。すすぎ洗いを十分にやり、形を整えてハンガーに掛け、陰干ししてください。火や熱風、アイロン、乾燥機などを使用して乾燥しないでください。
(26ページ「気室の取り付け、取り外し」の項を参照してください)



1. 年に1回、販売店を通じて定期点検を行ってください。
2. 救命衣を持ち運ぶときは、取扱説明書に記載された方法で正しく折り畳み、荷物などを上に載せないでください。破損や劣化の原因となります。
(27ページ「救命衣の折り畳み方法」の項を参照してください)
3. 直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に保管しないでください。特に、車の中に放置する事は絶対にしないでください。劣化の原因となります。
また、物の下積みにして、保管しないでください。


4. 長期間保管するときは、ハンガーにつり下げて保管してください。
5. 救命衣を雨の中で着用したときなどは、陰干しで十分乾燥させてから保管してください。

直射日光やストーブ、ドライヤーなどを使用して乾燥しないでください。いずれの場合も劣化、破損の原因となります。

6. カートリッジからは、炭酸ガスボンベの封板の穴の有無を検知するインジケータシャフトが出ています。けがの原因にもなりますし、シャフトを損傷するとカートリッジが使用できなくなります。カートリッジを取り付けるときは、取り扱いに十分注意してください。予備のカートリッジを保管するときは、必ず付属のケースに入れて保管してください。

3. 「型式」と「取り扱い注意」標示布の取り付け位置

救命衣の下図の位置に、「型式」と「取り扱い注意」の標示布が取り付けられています。救命衣をご使用になる前に、「取り扱い注意」の標示布をよくお読みいただき、正しい使用方法と取り扱い方法に従ってご使用ください。
「型式」と「取り扱い注意」の標示布は、切り取ったり、汚したりしないでください。

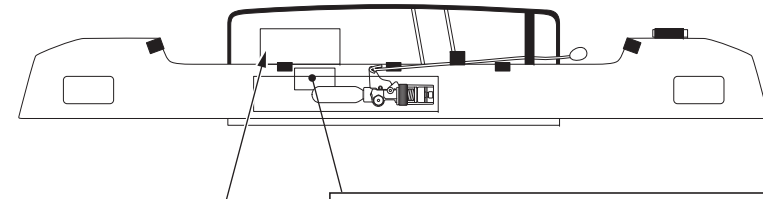

この部分に6～7ページに記載した、標示布A～Dが縫い付けられています。

作業用救命衣 (小型船舶用救命衣の要件に適合するもの) (膨張式)		購入日	
型 式	WP-2	点 検 記 録	
型式承認番号	第5337号	救命衣	カートリッジ
製 造 年 月	平成 年 月	点検	交換日
製 造 番 号	No.		
製 造 者 名	藤倉航装株式会社		
船名、船舶番号 又は船舶所有者名			
TYPE A			

標示布 A

<p>型 式 : WP-2 保 護 材 : ナイロンおよびポリプロピレン 浮力源 (膨張剤) : ナイロン繊維リトラント引糸 浮力源 (膨張剤) : 7.5kg以上/24時間 MADE IN JAPAN</p> <p>救命衣をご使用になる前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。</p> <p>■安全上、取り扱い上の注意について</p> <p>▲危険</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ガス充填装置を作動させたときは、取扱説明書に従って直ちに部品交換を行ってください。 2. この救命衣は意図のある人を対象としています。 3. お客様による改造、修理は絶対にしないでください。 <p>▲警告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. この救命衣は、身長140cm以上、腰回り寸法130cm以下の、手動によりガス充填装置を作動させることのできる大人用です。 2. 救命衣を使用するときは、取扱説明書に従って必ず自主点検を行い、ガス充填装置本体や炭酸ガスボンベ、カートリッジが使用できる状態になっているか、気室に空気が入っていないか確認してください。 3. 船内の保管などにより救命衣が熱くなっているときは、常温になってから着用してください。 4. この救命衣は、握り手を強く引いて作動させる。手動による作動が原則です。 5. 着用時、握り手が保護カバーの外に出ているか、必ず確認してください。 6. 気室を傷つけないでください。針などの鋭利なものや火気に注意してください。 7. 衣服の一番上に着用してください。 <p>▲注意</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 水に飛び込む高さは 3m 以下とし、手動で膨張させた救命衣を両手で抱きかかえて水に飛び込んでください。 2. 壁やロープなど、こすれ取らうな状態で使用しないでください。 	<p>海の「おしり」は 118番 海上保安庁へ</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. カートリッジは、交換時以外取り外さないでください。 4. ガス充填装置を気室から取り外さないでください。 <p>▲注意 (気室の洗濯について)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 気室は洗濯できません。洗濯機で洗ったり、手でも洗いすると、気室に亀裂が入るおそれがあります。 2. 気室に汚れや塩分などがついたときは、水を含ませたガーゼなどで軽くたたくようにして拭き取ってから、ハンガーに掛けて陰干ししてください。 <p>▲注意 (保護カバーの洗濯について)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保護カバーを洗濯するときは、気室を取り外してください。 2. 洗濯機を使用するときは、面ファスナーをしっかり閉じて、ネットに入れて洗ってください。濃色のものは色落ちすることがありますので、ほかの物とは一緒に洗わないでください。 3. 漂白剤の入った洗剤は使用しないでください。 4. すすぎ洗いを十分行い、形を整えてハンガーに掛け、陰干ししてください。 5. 火や熱風、アイロン、乾燥機などで乾燥させないでください。 6. ドライクリーニングはしないでください。 <p>重要</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 車の中など直射日光が当たる場所や、高温多湿の場所に保管しないでください。また物の下積みにして保管しないでください。 2. 水や汗で濡れたまま長時間放置しないでください。 <p style="text-align: right;">藤倉航装株式会社 〒142-0063 東京都品川区区原2丁目4番46号</p>
---	--

「型式と取り扱い注意標示布の取り付け位置」項は、次ページに続きます。

前ページより続く

標示布 B

救命衣の着用手順 (詳しくは、取扱説明書を参照してください)

▲ 警告
1. この救命衣は、身長140cm以上、腰回り130cm以下の、手動によりガス充填装置を作動させることができる大人用です。
2. 救命衣は、必ず衣服の上から着用してください。

1. バックル上下の装着つめの部分を強く押し、腰ベルトのバックルを外す。
2. 図のように、救命衣を肩骨のあたりで、腰の後ろにセットします。その際、必ず救命衣記載の矢印の向きを確認し、ラチェットメッシュの帯(裏面)が腰に当たる様に装着してください。

3. 腰ベルトのバックルをセットしてください。
4. バックルをセットしたら、必ず左右の腰ベルトの端を均等に引っ張って、救命衣を身体に密着させてください。
▲ 注意
● 片側の腰ベルトだけでなく、必ず左右のベルトを均等に引っ張って身体に救命衣を密着させてください。
5. 最後に、手動作用動索の握り手が、救命衣の外側に出ているか確認し、着用を終わります。

作動方法と膨脹後の送気 (詳しくは、取扱説明書を参照してください)

■ 手動による作動
1. 救命衣は手動による作動を原則としてください。
2. 握り手を前方に強く引いて救命衣を膨脹させてください。
3. 水中に飛び込むときは、膨脹させた救命衣を両手でしっかりと抱きかかえてください。
4. 飛び込む高さは3m以下としてください。
5. 病弱者や高齢者がなく、膨脹させずに水に飛び込んだ場合も、自動による作動に頼らず、握り手を前方に強く引いて膨脹させてください。

■ 膨脹後の送気操作
● 膨脹後、気温や水温の変化により気室の膨らみが足りなくなったときは、補助送気装置のキャップを外して、送気装置を口でくわえ、気室に息を吹き込んでください。

標示布 C

インジケーターの標示とシールビンの有無による使用の可否判断 (詳しくは、取扱説明書を参照してください)

○ 使用可
シールビンあり
ボンベインジケーターが赤色

▲ 警告
救命衣を使用する前に、ガス充填装置に新品の炭酸ガスボンベを取り付けられているか、またカートリッジ開口部のボンベインジケーターが使用時の表示色(緑色)になっているか、確認してください。

× 使用不可 (ボンベ交換・シールビン交換)
シールビンなし
ボンベインジケーターが赤色

× 使用不可 (ボンベ交換・カートリッジ交換)
シールビンあり
ボンベインジケーターが赤色

× 使用不可 (ボンベ交換)
シールビンあり
ボンベインジケーターが赤色

カートリッジの取り扱いについて (詳しくは、取扱説明書を参照してください)

▲ 警告
着水・膨脹使用後、水から上がった後もカートリッジのスプリング部から、救命のインジケーターが視認できないときは、ガス充填装置からカートリッジを取り外さないで、販売店を通してサービスステーションまたは弊社へ送付をお願いします。作動が不完全なカートリッジを取り外すと、部品が飛び出し、けがをするおそれがあります。

▲ 注意
1. 本体のカートリッジを水に漬けないでください。カートリッジが作動して部品が飛び出し、けがをするおそれがあります。
2. インジケーターのシャフトのリング部に砂やこみを付着させないでください。
3. インジケーターのシャフトだけが折れないよう、シャフトを破損しないよう、取り扱いには注意してください。
4. カートリッジを落したり、衝撃を加えたりしないでください。予期しない作動をしたり、逆に作動しなかったりするおそれがあります。
5. 一度取り付けたカートリッジは、交換時以外取り外さないでください。
重要：予備のカートリッジは、必ず付属のケースに入れたまま保管してください。

部品の交換 (詳しくは、取扱説明書を参照してください)

手順1 シールビンを変更する
手順2 炭酸ガスボンベを交換する
手順3 シールビンを変更する

標示布 D

救命衣の折り畳み方法 (詳しくは、取扱説明書を参照してください)

1. 気室の中に炭酸ガスや空気が残っているときは、補助送気装置を操作して完全に抜き取る。
▲ 警告
● 気室の空気を完全に抜き取ったら、補助送気装置のキャップを必ず送気口に装着する。

2. 図のように、ガス充填装置の付いている面を上にして、救命衣・気室を平らに広げてください。このとき、図のように、ガス充填装置の手動作用動索をトットボタンループとテールループに差し込んで握り手を保護カバーから出しておきます。また、透明のボンベカバーをかかせておきます。

3. 気室の下半分を裏側に折ります。

4. 気室の右側を面ファスナーに重ねない位置、及びカートリッジ基部に合わせて折ります。

5. さらにジャバラ状に折り、ベルトを保護カバー内面に面ファスナーで固定する。

6. 気室をカートリッジの下に差し込む。

7. 上側の気室を保護カバーの幅に合わせて折り返す。(カートリッジにかぶせないようにすること。)

8. 保護カバーを閉じた後、握り手が外に出ていることを確認する。

▲ 警告
● 救命衣の折り畳みが終わったら、手動作用動索の握り手が、保護カバーの外に出ているか確認してください。握り手が外に出ていないと、救命時に救命衣を作動させることができません。人命に関わる事柄ですので、必ず確認してください。

2 概要

1. 概要

この救命衣は、船外作業、港湾工事業、海岸工事業、あるいは小型船舶の操縦または同乗時など、水中に転落するおそれがある作業を行うとき、常時着用する膨脹式救命衣で、国土交通省の船舶設備規定に規定する作業用救命衣、および小型船舶安全規則に規定する小型船舶用救命衣の型式承認基準に適合しています。

使用者の条件は、身長が 140cm 以上、腰回り寸法 130cm 以下の、手動によりガス充填装置を作動させることのできる大人です。

膨脹した気室は 7.5kg (国土交通省の型式承認試験基準値) 以上の浮力を持っており、手動作用動索の握り手を引くと、気室が膨脹して使用者を水面に浮遊させます。補助機能として、水感知機能による自動作用機能も備えていますが、手動作用動索の握り手を引いて作動させる、手動での作動を基本としています。

主な構造と特長


1. 自動作用機能も備えていますが、手動での膨脹操作を基本としています。
2. 海上でも発見されやすいよう、気室の色にオレンジまたは黄色を採用しています。
3. 夜間でも発見されやすいよう、再帰反射材 (反射テープ) が取り付けられています。
4. 救命用の呼び笛が備え付けてあります。
5. 気室を保護カバーで保護し、気室の損傷や汚れを防止しています。また、保護カバーと気室が分離できる構造になっていて、保護カバーの洗濯が出来ます。

2. 主な仕様


項目	仕様	
型式承認番号	第5337号	
救命衣の用途	作業用、小型船舶用	
浮力方式	膨脹式 (※水感知機能付き)	
炭酸ガスボンベ容量	17g	
浮力性能 (膨脹時)	7.5kg以上	
質量	約800g以下	
材質	保護カバー	ナイロン
	ベルト	ポリプロピレン
	気室	ナイロン片面ポリウレタン引き布
製品色	保護カバー	赤、紺、黒など
	気室	オレンジまたは黄色

※注：水感知機能による自動作用は、あくまでも補助的な機能です。自動作用機能に頼ることなく、手動作用動索の握り手を引く、手動作用を基本としてください。


3. 主要部の名称と機能

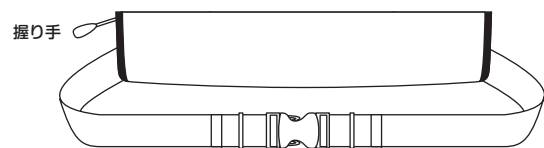

腰ベルト

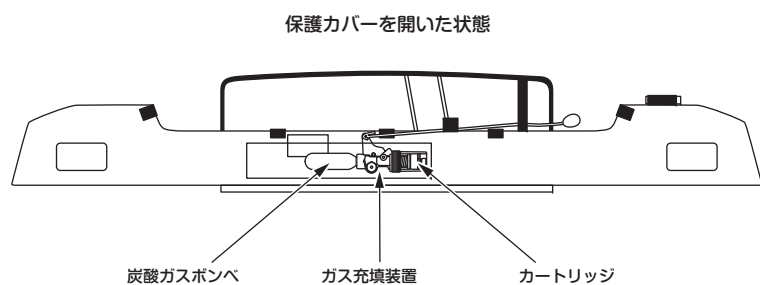


炭酸ガスポンペ ガス充填装置 カートリッジ

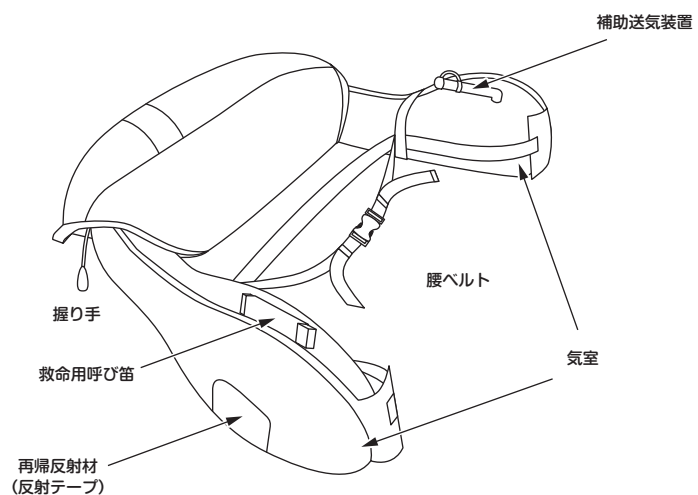

4. ガス充填装置の構造

ガス充填装置は、

1. 炭酸ガスポンペとカートリッジを接続する「本体」
2. 気室を膨脹させる「炭酸ガスポンペ」
3. 水を感じると作動する「カートリッジ」
4. ガス充填装置を手動で作動させる「手動作用動索と握り手」から構成されています。

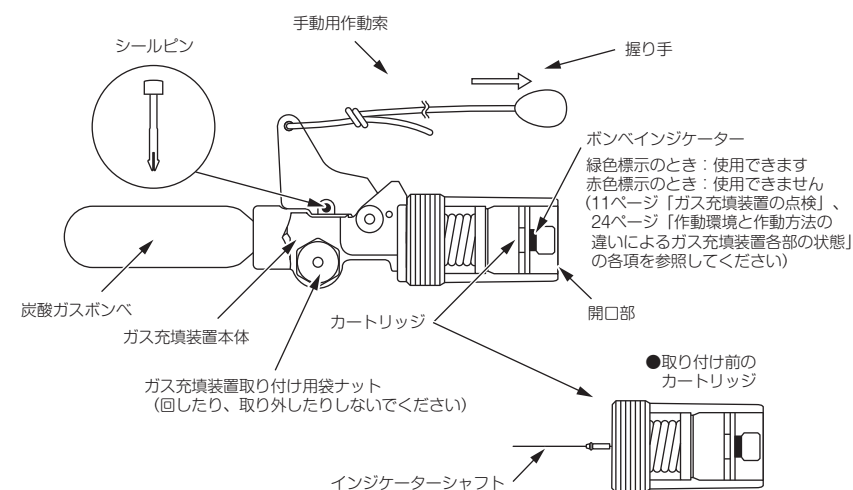


ガス充填装置の握り手（手動作用動索）を引くと、シールピンが切れてレバーが作動し、撃針が作動して炭酸ガスポンペの封板を破り、ボンベ内の炭酸ガスが救命衣の気室に流入して気室を膨脹させます。

また、手動での作動ばかりでなく、水を感じると作動するカートリッジを使用した自動作動機能も備えています。

ただし、この救命衣は握り手（手動作用動索）を引いて作動させる手動操作を基本としています。自動作動機能は、あくまでも補助的な機能です。



- ガス充填装置の取り付け用袋ナットを取り外して、気室からガス充填装置を取り外さないでください。また、袋ナットの増締めはしないでください。ガス充填装置を損傷するおそれがあります。

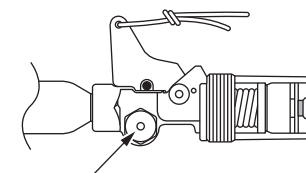

ガス充填装置取り付け用袋ナットは、取り外さない、増締めしない。

3 使用前の自主点検




1. 使用前の自主点検は、使用者の人命に直接つながる事柄です。救命衣を使用するときは、必ず自主点検を行い、異常や損傷を発見したときは、絶対に救命衣を使用しないでください。
2. 修理の必要があるときは、必ず販売店を通じてサービスステーションまたは弊社にお申し付けください。絶対に、お客様の独自の判断で修理を行わないでください。お客様が行った修理が、重大な事故の原因になるおそれがありますので、厳守してください。


1. ガス充填装置の点検

正常に作動するガス充填装置は、各部が右図のようになっています。救命衣を着用する前に、以下の1～5項の点検事項に従って、ガス充填装置が右図のようになっているか必ず確認してください。

(13ページの「救命衣の点検」、24ページの「作動環境と作動方法の違いによるガス充填装置各部の状態」の各項をあわせて参照してください)

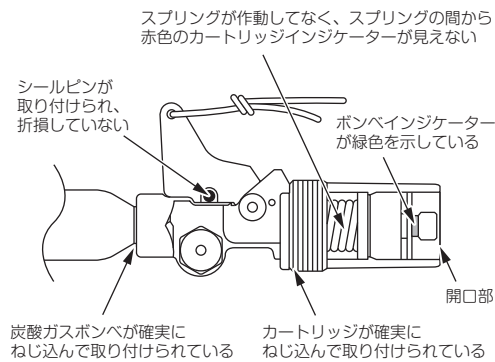

1. シールピンが挿入されていますか。折損していませんか。

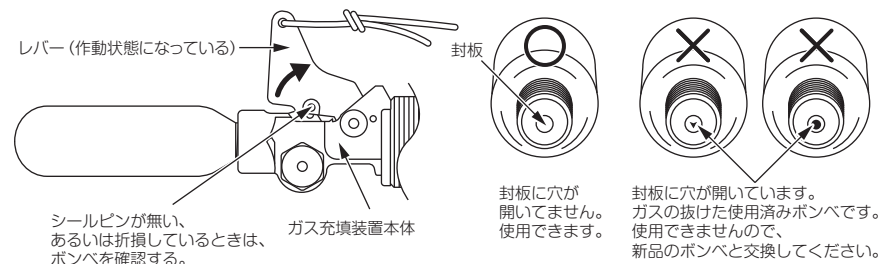

レバーが作動していて、シールピンが無い、あるいは折損しているときは、使用済みのボンベが取り付けられている可能性があります。一度、炭酸ガスボンベを取り外して、ボンベの封板に穴が開いていないか、刺し傷がないか確認してください。ボンベが使用済みの場合は、新品のボンベとシールピンに交換してください。




- 小さな刺し傷の場合は、カートリッジ開口部のボンベインジケータでは検知できません。シールピンに異常があるときは、必ず炭酸ガスボンベを取り外してボンベの封板を点検してください。

「ガス充填装置の点検」項は、次ページに続きます。

前ページより続く

2. カートリッジ開口部のボンベインジケータの色は緑色ですか。

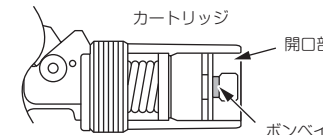


カートリッジ開口部のボンベインジケータの色が赤色になっているときは、シールピンの有無、折損にかかわらず、使用済みの炭酸ボンベが取り付けられています。前項のボンベの図を参考にボンベを確認し、新品のボンベと交換し、シールピンが折損しているときはシールピンも交換してください。

ボンベインジケータ
 緑色：新品のボンベが取り付けられています。使用できます。
 赤色：使用済みのボンベが取り付けられています。使用できません。



- カートリッジ開口部のボンベインジケータが赤色を示しているときは、シールピンの有無、折損にかかわらず、炭酸ボンベが使用済みになっています。ボンベを確認して新品のボンベと交換し、シールピンが折損しているときは、シールピンも交換してください。

3. カートリッジ中間部のスプリングが作動して、スプリングの隙間から赤色のカートリッジインジケータが見えていませんか。

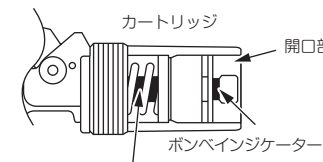


シールピンの有無、折損にかかわらず、カートリッジ中間部のスプリングが作動して、スプリングの隙間から赤色のカートリッジインジケータが見えるとき、さらに、カートリッジ開口部のボンベインジケータも赤色になっているときは、前回の使用時に自動作動機能が作動しています。新品の炭酸ガスボンベとカートリッジに交換し、シールピンが折損しているときはシールピンも交換してください。



- カートリッジ中間部のスプリングが作動して、スプリングの隙間から赤色のカートリッジインジケータが見えるときは、カートリッジも炭酸ガスボンベも使用済みです。新品のカートリッジとボンベに交換し、シールピンが折損しているときは、シールピンも交換してください。

4. 炭酸ガスボンベが、ガス充填装置本体に確実にねじ込んでありますか。

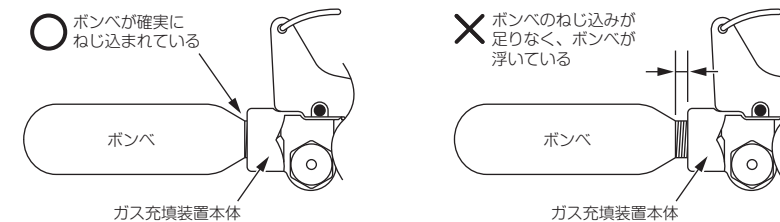


- 炭酸ガスボンベの取り付けが不完全ですと、最悪の場合、救命衣が膨張しないことがあります。ボンベは確実に取り付けてください。

「ガス充填装置の点検」項は、次ページに続きます。

前ページより続く

5. カートリッジが、ガス充填装置本体に確実にねじ込んでありますか。

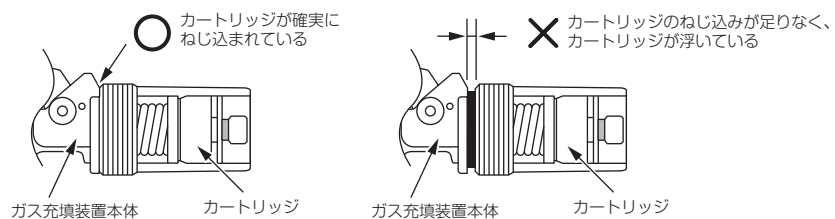



注意

●カートリッジの取り付けが不完全ですと、最悪の場合、救命衣が膨張しないことがあります。カートリッジは確実に取り付けてください。

2. 救命衣の点検

救命衣を着用する前に、次ページの1～7項の点検項目に従って、必ず救命衣を点検してください。

(11ページ「ガス充填装置の点検」の項も合わせて参照してください)

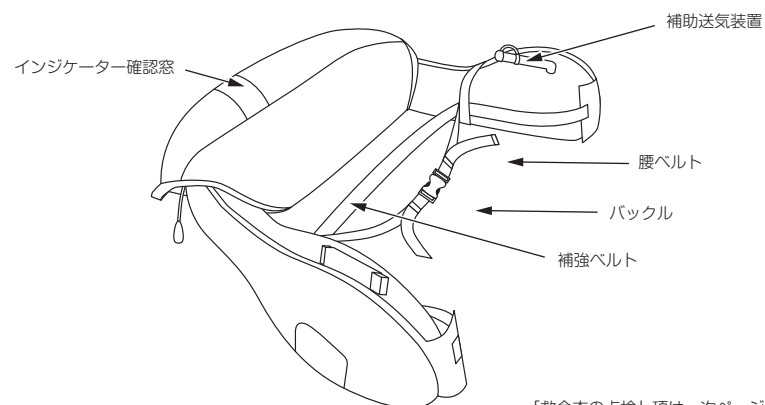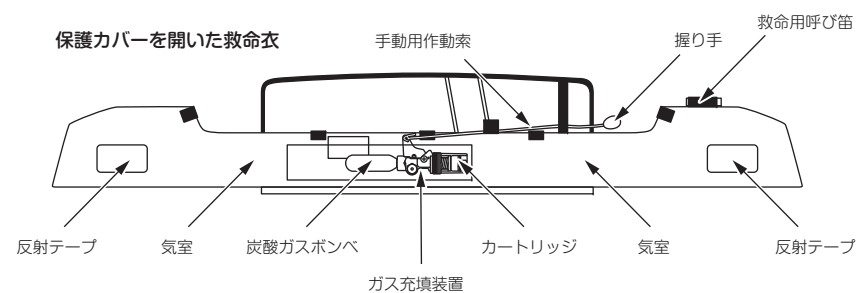

「救命衣の点検」項は、次ページに続きます。

13

前ページより続く

■救命衣の点検項目

1. 気室や保護カバーに傷や損傷がありませんか。
2. 縫製部にほつれや糸切れがありませんか。
3. すべての面ファスナーが確実に取り付けられ、ほつれなどの損傷がありませんか。
4. 腰ベルトや補強ベルトに損傷がありませんか。バックルやアジャスターに損傷がありませんか。バックルは正常に機能しますか。
5. 補助送気装置に損傷がありませんか。正常に機能しますか。



警告

●以上、1～5の点検で異常や損傷を発見したときは、救命衣を使用しないで、販売店を通じてサービスステーションまたは弊社で点検、修理をしてください。
そのまま使用すると、重大な人身事故につながるおそれがあります。

6. 救命衣が折り畳まれた状態で、気室が膨らんでいませんか。

1. 気室が膨らんでいるときは、炭酸ガスボンベ内のガスが漏れているおそれがあります。ボンベを取り外して、ボンベの封板に穴が開いていないか確認し、必要であれば新品のボンベに交換し、救命衣内のガスを抜いてから畳み直してください。
(11ページ「ガス充填装置の点検」の項の1項、20ページ「補助送気装置」、27ページ「救命衣の折り畳み方法」の各項を参照してください)
2. 救命衣を着用する前に、補助送気装置から空気を吹き込みませんでしたか。空気を注入すると、ガス充填装置が作動したとき、気室内の圧力が過大になりすぎて、気室が破裂するおそれがあります。救命衣内の空気を抜いてから畳み直してください。
(20ページ「補助送気装置」、27ページ「救命衣の折り畳み方法」の各項を参照してください)

7. 救命衣が正しく折り畳まれ、手動作用動索の握り手が、保護カバーの外に出ていますか。

握り手が保護カバーから出ていないときは、救命衣を畳み直してください。
(27ページ「救命衣の折り畳み方法」の項を参照してください)

14

4 着用

救命衣を着用するときは、以下の注意と手順に従ってください。



1. 救命衣を着用するときは、その都度、11～14ページの「使用前の自主点検」の項に従って、ガス充填装置と救命衣の自主点検を行ってください。

自主点検で異常や損傷を発見したときは、そのまま救命衣を使用しないでください。

2. この救命衣は、身長 140cm 以上、腰回り寸法 130cm 以下の、手動によりガス充填装置を作動させることができる大人用です。

上記の条件を満たしていない人は、使用しないでください。

3. 救命衣を着用する前に、ブローチ、ボールペン、ネクタイピン、安全ピンなど、気室を傷つけるおそれのある突起物や鋭利な物は、身体から取り外してください。

気室を傷つけると、最悪の場合、救命衣が膨張しなかったり、空気漏れを起こしたりするおそれがあります。安全のため厳守してください。

4. 救命衣は、必ず衣服の上から着用してください。

救命衣を作業服や雨衣の下に着用すると、手動作用動索の握り手を探すのに手間取ったり、水の浸入が妨げられてガス充填装置が自動作動しなかったりするおそれがあります。

また、救命衣の上に服を着用すると、気室の膨張が妨げられ、正常に膨張しないおそれがあります。

5. 着用するときは、手動作用動索の握り手が保護カバーの外に出ていて、手で引ける状態であるか確認しながら着用してください。

手動作用動索の握り手が保護カバーの外に出ていないと、緊急時に握り手を探すのに手間取ったりするなど、即、人命を危険にさらすことになります。

6. 救命衣を取り扱うときは、火気に注意してください。


救命衣の気室は、ナイロン布にポリウレタンをコーティングした引き布で作られています。火気を近づけると穴があき、使用できなくなります。ストーブやタバコの火などには十分注意してください。

以上の注意事項は、使用者の人命に直接つながる事柄です。厳守してください。


前ページより続く

■着用の手順


1. 図のように、救命衣を腰骨のあたりで、腰の後ろにセットします。その際、必ず救命衣記載の矢印の向きを確認し、ラッセルメッシュの面（裏面）が腰に当たる様に装着してください。



2. バックルを差し込んでセットしてください。バックルを外す時は図の矢印を強く押すとバックルは左右に離れます。

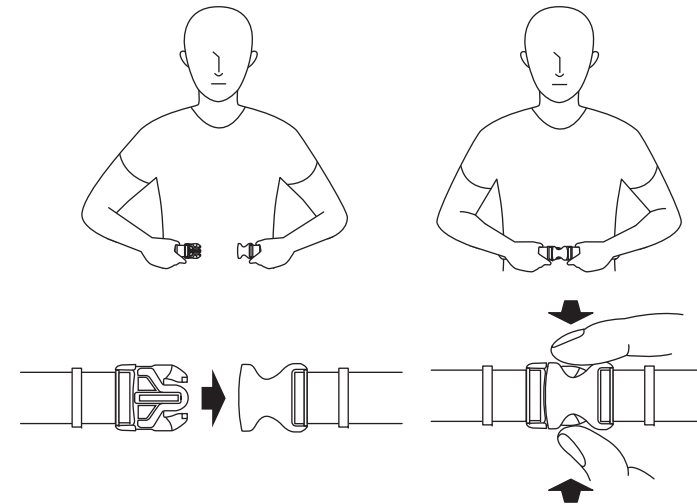

3. バックルをセットした後、腰ベルトの末端を図のように両側に引っ張って、救命衣が腰の周りに密着するように調整してください。このとき、腰ベルトをあまり強く引き過ぎると、気室が救命衣から飛び出す恐れがあるので、注意してください。気室が飛び出した場合は、必ず正しい折りたたみ方法に従って折たたみ直してください。救命衣を腰にセットする前にあらかじめ腰ベルトを腰周りの長さに調整し、あとはバックルをセットするだけにしておくと容易に着用できます。




「着用の手順」項は、次ページに続きます。

前ページより続く

4. 救命衣が腰の後ろに密着するように、腰ベルトを左右均等にしっかりと締めつけてください。

腰ベルトをしっかりと締めつけていないと、水中で気室が膨張した時、身体が気室から抜け落ちることがあります。

また、腰ベルトが左右均等に締めつけられていないと、気室が膨張していく過程において、気室が脇の下に正しく装着されないことがあります。

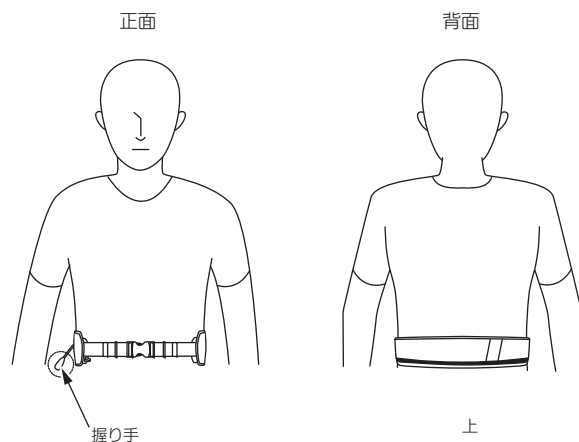

警告

1. 救命衣は衣服等の一番上に着用してください。
2. 衣服又は雨衣の下に着用しますと、水の侵入が遅くなり、自動膨張装置が作動しない恐れがあります。また、救命衣の上に服を着用すると、気室の膨張を妨げ、正常な状態で膨張しません。

5 作動方法と膨張後の送気操作

1. 手動作動と自動作動


この救命衣は、手動作用動索の握り手を引いて作動させる手動作動（膨張）と、カートリッジの水感知機能による自動作動（膨張）の2方式を採用しています。

●手動による作動

手動作用動索に取り付けられた「握り手」を強く引くことにより、救命衣の腰の位置に取り付けられたガス充填装置の撃針が作動し、炭酸ガスポンベの封板に穴を開け、気室を膨張させます。

基本として救命衣の作動は、この「手動による作動」で行ってください。

(次ページの「手動による作動」の項を参照してください)

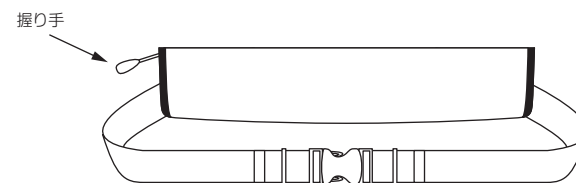


●自動による作動

水中に飛び込むと、救命衣の腰の位置に取り付けられたガス充填装置のカートリッジ内に水が入り、水を感じたカートリッジにより撃針が作動し、炭酸ガスポンベの封板に穴をあけ、気室を膨張させます。

ただし、この水感知機能による自動作動（膨張）は、あくまでも補助的な機能です。救命衣の作動は、上記の「手動による作動」をあくまでも原則としてください。

膨張させる時間的余裕がなく水中に飛び込んだ場合も、自動による作動に頼らないで、「握り手」を引いて手動で救命衣を膨張させてください。



「作動方法と膨張後の送気操作」項は、次ページに続きます。

前ページより続く


2. 手動による作動

救命衣は、手動による作動を原則としてください。
船が沈み始めて脱出するときなど、時間的にまだ余裕があるときは、手動用作動索の「握り手」を前方に強く引いて、救命衣を膨脹させてから脱出してください。

時間的な余裕がなく、膨脹させずに水に飛び込んだ場合も、自動による作動に頼らないで、手動用作動索の「握り手」を前方に強く引いて、手動で膨脹させてください。

水中に飛び込むときは、膨脹させた救命衣を両手でしっかり抱きかかえてください。飛び込み高さは「3m以下」としてください。

(16ページ以降の「着用の手順」、18ページの「手動作動と自動作動」の各項を参照してください)



握り手を前方に強く引く



警告

救命衣は、手動による作動を原則としてください。
この救命衣に装備されたガス充填装置は、水感知機能付きで着水時に水を検知すると、自動的に作動する仕組みになっていますが、この機能はあくまでも補助的な機能です。水中に脱出するときや、落水してしまったときは、自動による作動に頼らないで、必ず、手動用作動索の握り手を引いて手動で作動させてください。



注意

1. 水に飛び込むときの、飛び込み高さは「3m以下」としてください。また、水中に飛び込むときは、救命衣を両手でしっかり抱きかかえてください。
2. 水中で浮遊しているとき、救命衣を損傷するおそれのある浮遊物には近づかないでください。


気室に傷をつけると、最悪の場合、空気漏れを起こして浮力を失うおそれがあります。

前ページより続く

3. 補助送気装置（作動後の送気、排気操作）

●送気操作


この補助送気装置は、気温や水温の変化などにより気室内の炭酸ガスが少なくなり、十分な浮力が得られなくなったとき使用します。補助送気装置のキャップを外して、送気装置の送気口を直接口でくわえ、息を吹き込むことにより気室内に空気を充填できます。



また、送気装置は救命衣の使用が終わって収納するときに、気室内の炭酸ガスや空気を抜くときにも使用します。送気装置のキャップを外し、キャップのつめを送気装置の送気口の中に軽く押し込むと、気室内の炭酸ガスや空気が排気できます。

●排気操作

キャップのつめを送気口に入れて軽く押す




補助送気装置



危険

●排気や排気操作が終わりましたら、補助送気装置のキャップを必ず送気口に装着してください。キャップのつめを送気口に刺したままにしておくと、気室内の空気が抜けたり、緊急時に気室が膨脹しないおそれがあります。
また、気室内への水の侵入や送気装置のバルブへのごみの付着を防ぐこともできます。




送気、排気操作が終わったらキャップを必ず装着する。

絶対にキャップを挿したままにしない。

6 膨脹使用後の部品交換




- 着水・膨脹使用后、水から上がってもカートリッジのスプリング部から、赤色のカートリッジインジケータが視認できないときは、ガス充填装置からカートリッジを取り外さないで、販売店を通じてサービスステーションまたは弊社へ点検を依頼してください。作動が不完全なカートリッジを取り外すと、部品が飛び出し、けがをするおそれがあります。

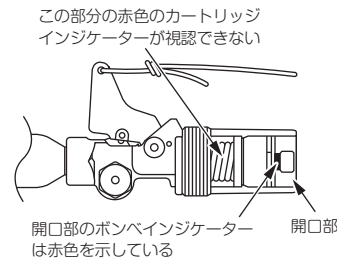

●カートリッジを取り扱うときの注意事項



1. 単体のカートリッジを水に漬けないでください。カートリッジのスプリングが作動して部品が飛び出し、思わぬけがの原因となります。また、カートリッジを交換するときは、ガス充填装置の本体内部に水分が残っていないかよく確認してください。水分が残っていると、交換中にカートリッジが作動してしまうおそれがあります。
2. カートリッジのOリング部に砂やごみなどを付着させないでください。この部分を手で触れないでください。Oリング部にはグリースが塗ってあります。手で触ったり、砂やごみが付着すると、ガス充填装置の作動に不具合を起こすことがあります。
3. カートリッジからは、炭酸ガスボンベの封板の穴の有無を検知するインジケータシャフトが出ています。シャフトの先が目や手に刺さると、失明や思わぬけがの原因となります。のぞき込んだりしないよう、取り扱いには注意してください。幼児には触れさせないでください。
4. カートリッジを落としたり、衝撃を加えたりしないでください。予期しない作動をしたり、逆に作動しなくなったりするおそれがあります。
5. カートリッジは、交換時以外取り外さないでください。



1. 予備のカートリッジを保管するときは、必ず付属のケースに入れた状態で保管してください。
2. 使用済みのカートリッジを廃棄するときは、交換で空いたカートリッジケースの中に入れて、適正に廃棄してください。

1. 交換の手順

部品の交換は、下記の手順に従って行ってください。

(24ページ「作動環境と作動方法の違いによるガス充填装置各部の状態」の項の図をあわせて参照してください)




- 炭酸ガスボンベ、カートリッジ、シールピンの交換をするときは、下記の手順を守ってください。手順を間違えて、作動済みのカートリッジを交換する前に、新品の炭酸ガスボンベを取り付けるとボンベに穴が開き、ボンベが使用できなくなります。

1. まず最初に、カートリッジを新しいものに交換します。

地上で握り手を引いて作動させ着水していない場合や、過ぎて握り手を引っ掛けて作動させてしまった場合などは、カートリッジが作動していません。この場合は、カートリッジの交換は不要です。

カートリッジからは、ボンベインジケータを作動させるインジケータシャフトが出ています。取り付けの際はこのシャフトを曲げないように、ガス充填装置本体の赤い部品の穴に、まっすぐに挿入して確実にねじ込んでください。

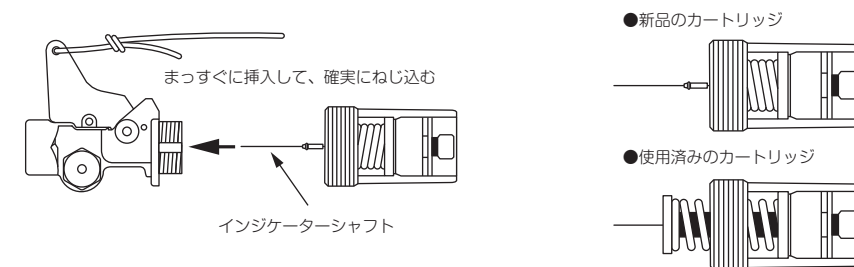


1. ガス充填装置内部に水分が残っていないかよく確認してから、カートリッジを取り付けてください。水分が残っていると、取り付け中にカートリッジが作動してしまうおそれがあります。
2. カートリッジは、確実にねじ込んでください。カートリッジとガス充填装置本体との間に隙間があると、カートリッジが作動しても、炭酸ガスボンベが作動しないおそれがあります。
3. インジケータシャフトは、まっすぐに挿入してください。曲げて挿入すると、インジケータが作動しないおそれがあります。

「交換の手順」項は、次ページに続きます。

前ページより続く

2. 炭酸ガスポンペを新しいものに交換します。


新しい炭酸ガスポンペを取り付けると、カートリッジ開口部のボンペインジケターが赤色から緑色に変わります。

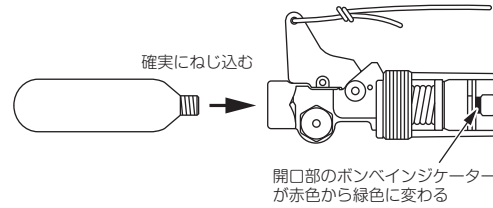

●炭酸ガスポンペは、確実にねじ込んでください。しっかりねじ込まないと、ボンペが作動しても炭酸ガスが漏れて、気室が膨脹しないおそれがあります。

3. シールピンを新しいものに交換します。

手動作用索の握り手を引っ張って作動させたときは、シールピンが折損していますので、交換が必要になります。カートリッジのみが作動した自動作動の場合は、シールピンの交換は必要ありません。


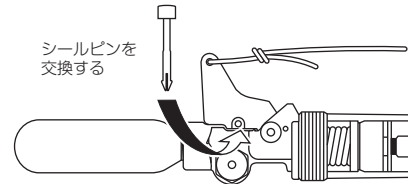


以上で交換の手順を終わります。

以下に、作動環境と作動方法の違いによるガス充填装置のインジケター標示と、交換が必要な部品一覧を掲載します。

(24ページ「作動環境と作動方法の違いによるガス充填装置各部の状態」の項の図をあわせて参照してください)

●交換部品一覧




作動環境と作動方法 交換部品	着水して		着水しないで握り手を引いた
	握り手を引いた	握り手を引いていない (自動作動をした)	
炭酸ガスポンペ	炭酸ガスポンペに穴が開いています。【使用不可、要交換】		
シールピン	折損しています。 【使用不可、要交換】	折損していません。 【使用可、交換不要】	折損しています。 【使用不可、要交換】
カートリッジ	スプリングが作動して、赤色のカートリッジインジケターが見えています。  開口部 ボンペが使用済みですので開口部のボンペインジケターが赤色を示しています。 スプリングが作動して使用できません。 【使用不可、要交換】	スプリングが作動していないので、赤色のカートリッジインジケターは見えません。  開口部 ボンペが使用済みですので開口部のボンペインジケターが赤色を示しています。 スプリングが作動していません。 【使用可、交換不要】	

前ページより続く


2. 作動環境と作動方法の違いによるガス充填装置各部の状態

この救命衣は、地上での手動作動、着水しての自動作動、着水しての手動、自動両作動など作動環境と作動方法の違いにより、カートリッジのインジケターやシールピンの状態が異なります。以下に、それぞれの場合の図を掲載しますので参考にしてください。

(11ページ「使用前の自主点検」、23ページ「交換部品一覧」の各項をあわせて参照してください)

地上で手動作動をしたが 着水していない	× ボンペとシールピン 使用不可  レバー レバーが作動して、シールピンが折損している スプリングが作動していない 赤色のカートリッジインジケターが見えない 開口部のボンペインジケターが赤色を示している	交換部品		
		ボンペ 交換する	カートリッジ 交換不要	シールピン 交換する
着水による自動作動のみをした	× ボンペとカートリッジ 使用不可  シールピンは折損していない スプリングが作動し、スプリングの隙間から赤色のカートリッジインジケターが見える 開口部のボンペインジケターが赤色を示している	交換部品		
		ボンペ 交換する	カートリッジ 交換する	シールピン 交換不要
着水して手動、自動の両作動をした	× ボンペ、カートリッジ、シールピン使用不可  レバー レバーが作動して、シールピンが折損している スプリングが作動し、スプリングの隙間から赤色のカートリッジインジケターが見える 開口部のボンペインジケターが赤色を示している	交換部品		
		ボンペ 交換する	カートリッジ 交換する	シールピン 交換する

●カートリッジ、シールピンを新品に取り替えたが、過って使用済みのポンペを取り付けてしまったとき

過って使用済みのポンペを取り付けた	× ボンペが使用済み  シールピンは折損していない 開口部のボンペインジケターが赤色を示している	新品のカートリッジと、シールピンを取り付けたガス充填装置に、誤って使用済みのポンペを取り付けてしまったときは、図のようになります。 新品のボンペに交換してください。カートリッジとシールピンは使用できます。

7 着用後、膨脹使用後の整備

1. 着用後の整備



- 絶対に、保護カバーや気室の汚れ落としに、ガソリンやシンナーなどの溶剤を使用しないでください。救命衣が使用できなくなります。

1. 気室を保護している保護カバーに損傷がありませんか。また、縫製部にほつれや糸切れなどありませんか。

保護カバーに損傷を発見したときは、保護カバーを開いて中の気室に損傷がないか、必ず確認してください。

2. 保護カバーに汚れや塩分などがついたときは、水や中性洗剤を含ませたガーゼなどで軽くたたき取って拭き取ってから、ハンガーに掛けて陰干ししてください。

洗濯機を使用して保護カバーを洗濯するときは、保護カバーを気室から取り外し、保護カバーの面ファスナーを閉じて、ネット袋に入れて洗濯してください。濃色のものは色落ちすることがありますので、ほかの物とは一緒に洗わないでください。ドライクリーニングはしないでください。漂白剤の入った洗剤は使用しないでください。すすぎ洗いを十分に行い、形を整えてハンガーに掛け、陰干しにしてください。火や熱風、アイロン、乾燥機などで乾燥させないでください。

(26ページ「気室の取り付け、取り外し」の項を参照してください)



- 気室を装着したまま、保護カバーを水で洗い流さないでください。保護カバーの中に水が入り、カートリッジが作動するおそれがあります。

3. 気室についた汚れは、水を含ませたガーゼなどで軽くたたき取って拭き取ってから、ハンガーに掛けて陰干ししてください。気室は洗濯できません。洗濯機で洗ったり、手でもみ洗いしないでください。火や熱風、アイロン、乾燥機などで乾燥させないでください。



- 気室を洗濯機で洗ったり、手でもみ洗いしないでください。気室に亀裂が入り、救命衣が使用できなくなります。

前ページより続く

2. 膨脹使用後の整備

膨脹使用後は、21ページの「膨脹使用後の部品交換」、27ページの「救命衣の折り畳み方法」の各項に従って、正しく整備を行ってください。

また、整備後の使用時には、11ページの「使用前の自主点検」の項に従って、必ず自主点検を実行してください。



- 部品の交換を怠ったり、折り畳みの手順を守らなかったりすると、人身事故の原因となります。人命に関わることでありますので、必ず部品を点検のうえ交換し、正しく折り畳んでください。




- 膨脹使用後、救命衣の洗浄をするときは、使用済みの炭酸ガスボンベとカートリッジを取り外さないで洗浄してください。取り外すと、ガス充填装置の本体内に水が入るおそれがあり、ガス充填装置に悪影響を及ぼします。

3. 気室の取り付け、取り外し

保護カバーの交換や洗濯をするときは、下記の手順で、気室から保護カバーを取り外してください。取り付けは、取り外しと逆の手順で行ってください。

1. 保護カバーの面ファスナーを開いて、ドットボタンをはずして手動用動作索を保護カバーからはずします。

2. 3箇所の面ファスナをはずして気室と保護カバーを分離します。

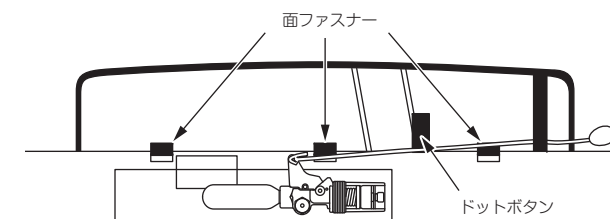

8 救命衣の折り畳み方法

救命衣は、以下の手順で正しく折り畳んでください。

1. 気室の中に炭酸ガスや空気が残っているときは、補助送気装置を操作して完全に抜き取ります。

(20ページ「補助送気装置」の項を参照してください)



危険

●気室の空気を完全に抜き取ったら、補助送気装置のキャップを必ず送気口に装着してください。キャップのつめを送気口に刺したままにしておくと、緊急時に気室が膨張しないおそれがあります。また、気室内への水の侵入や送気装置のバルブへのごみの付着を防ぐことができます。

●補助送気装置



排気操作が終わったらキャップを必ず装着する。




絶対にキャップを刺したままにしない。



警告


●折り畳む前に、気室内に残っている炭酸ガスや空気を必ず抜いてください。気室内に炭酸ガスや空気が残っていると、ガス充填装置が働いたとき気室内の圧力が過大になり、気室が破裂するおそれがあります。

2. 図のように、膨脹装置の付いている面を上にして、救命衣・気室を平らに広げてください。(後側にベルトがあるため、図のようには広がりません。出来る範囲で広げてください。また、救命衣の下や周囲に救命衣・気室を傷つけるようなものを置かないように注意してください。)

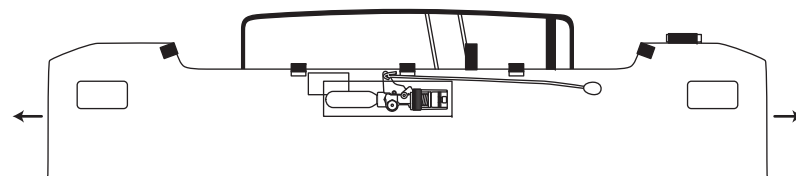


「救命衣の折り畳み方法」の項は、次ページに続きます。


3. このとき、図のように、膨脹装置と作動索でつながれている握り手をドットボタンループとテーブループに通して握り手をカバー布から出しておきます。また、透明のボンベカバーををかぶせておきます。

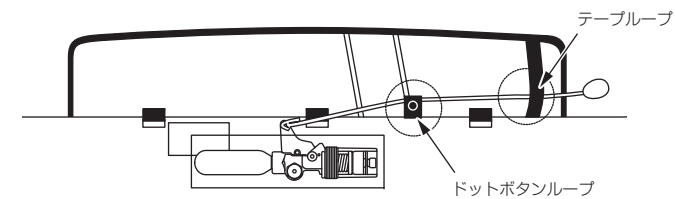

4. 再帰反射材の外側のところで裏側に折り、気室の下半分を裏側に折ります。(後側にベルトがあるため、図のようには広がりません。できる範囲で広げてください。)

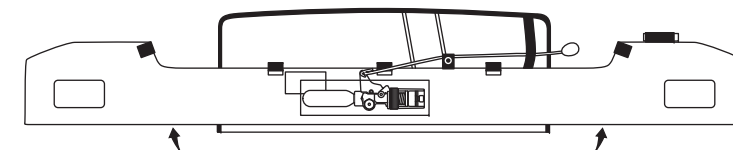


5. 気室の右側を面ファスナーに重ならないような位置、及びカートリッジ端部に合わせて折ります。(気室は片方ずつ折り畳んでください。)

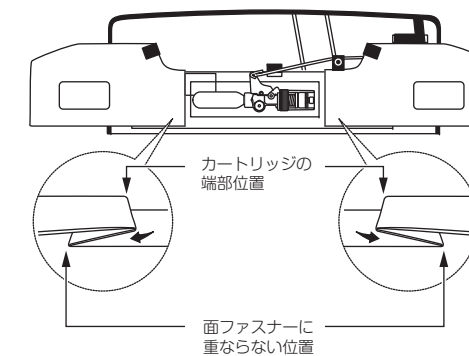


「救命衣の折り畳み方法」の項は、次ページに続きます。

前ページより続く


6. さらにジャバラ状に折り、ベルトとカバー布を面ファスナーで固定する。

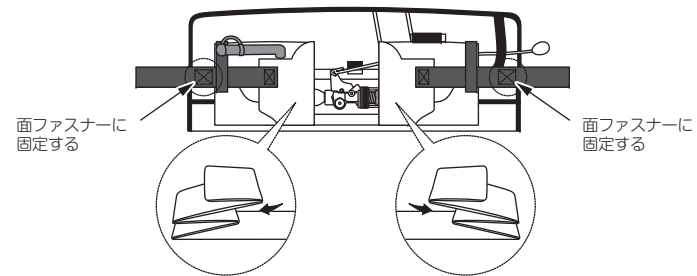

7. 気室をインジケーターの下に差し込む。

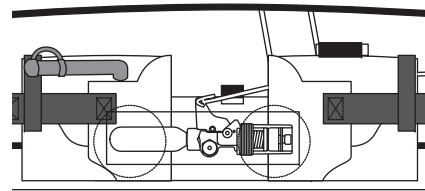


8. 上側の気室をカバー布の幅に合わせて折り返す。
(インジケーターにかぶせないようにすること。)

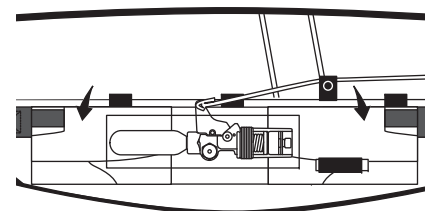

「救命衣の折り畳み方法」の項は、次ページに続きます。

前ページより続く

9. 気室左側も同様に折り、(炭酸ガスボンベの下に気室を差し込む) 気室下側をカバー布に入れ、カバー布上側を閉じる。

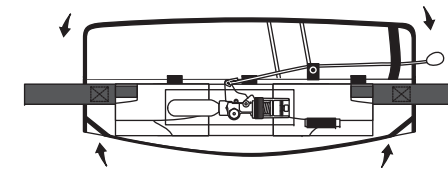

10. カバー布を閉じた後、握り手が外に出ていることを確認する。



9 保管とメンテナンス

1. 救命衣の保管

この救命衣は、主要部がナイロンにポリウレタン加工をした引き布で作られています。したがって、高温多湿環境で保管したり、物の下積みなどになって荷重をかけられた状態で保管すると、劣化したり破損したりします。

救命衣を保管するときは、以下の事柄に注意して保管してください。

1. 直射日光の当たる場所に保管しないでください。
2. 風通しのよい、乾燥した場所に保管してください。
3. 水滴のかかる場所、蒸気のかかる場所に保管しないでください。
4. 暖房装置の近くなど、高温になる場所に保管しないでください。
5. 物の下積みにして、保管しないでください。
6. ねずみの害が予想される場所に保管しないでください。
7. 長期間保管するときは、ハンガーに掛けて保管してください。



●高温環境や多湿環境での保管、物の下積み保管は、救命衣の劣化を早めます。保管場所や保管方法には十分ご注意ください。

2. 使用期限について

以下の場合には、使用を中止して部品交換を行ってください。

●炭酸ガスボンベについて

1. 購入後、5年を経過したもの。
2. 傷、打痕、さび、変形があるもの。

●カートリッジについて

購入後、3年を経過したもの。

ただし、使用・保管環境によっては、3年以内でも部品の劣化が始まる場合がありますので、1年ごとの交換をお勧めします。

●上記消耗品以外について

上記の消耗品に限らず、下記の場合はすべて使用禁止です。使用を中止して、お買い求めの販売店を通じて修理を行うか、修理ができないときは新しくお買い求めてください。

1. 救命衣の気室が破損しているとき。
2. 補助送気装置が破損しているとき。
3. 腰ベルト、補強ベルト、バックルが破損しているとき。
4. 面ファスナーなどの縫い糸にほつれ、ほころび、切れなどがあるとき。保護カバーが破れているとき。

3. 定期点検

救命衣を安全にご使用いただくために、1年に1回、お買い求めの販売店を通じて、サービスステーションまたは弊社での定期点検を行ってください。

定期点検の結果は、お買い求めの販売店を通じてご連絡申し上げます。



1. 定期点検の結果は、お買い求めの販売店を通じてご連絡申し上げます。点検の結果、損傷、不具合などの指摘を受けられたときは、そのまま使用しないで、必ずサービスステーションまたは弊社にご依頼いただき、修理や部品交換を行ってください。
2. 特に、気密性能試験が不合格になった救命衣は、使用できません。人命に関わりますので、修理できない状態の場合は、新しい救命衣をお買い求めください。